


# دستگاه

## Passive Avoidance Apparatus

- مناسب برای انجام آزمایشات مربوط به اثرات دارو روی حافظه
- طراحی زیبا و مقاوم از جنس plexiglass که به راحتی قابل شستشو و نظافت می باشد.
- دارای دو محفظه سفید و مشکی به ابعاد 30×20×30 سانتیمتر
- سیستم الکترونیکی تشخیص وجود Rat در هر یک از اتاقهای تاریک و روشن
- واحد کنترل الکترونیکی به همراه نمایشگر LCD برای تنظیم و نمایش پارامترهای سیستم
- ثبت خودکار زمان حضور Rat در هر یک از محفظه ها با دقت ثانیه
- شوک الکتریکی قابل تنظیم در بازه وسیعی از شدت جریان، فرکانس و مدت زمان اعمال شوک
- قابلیت اعمال شوک دستی و اتوماتیک
- قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط USB

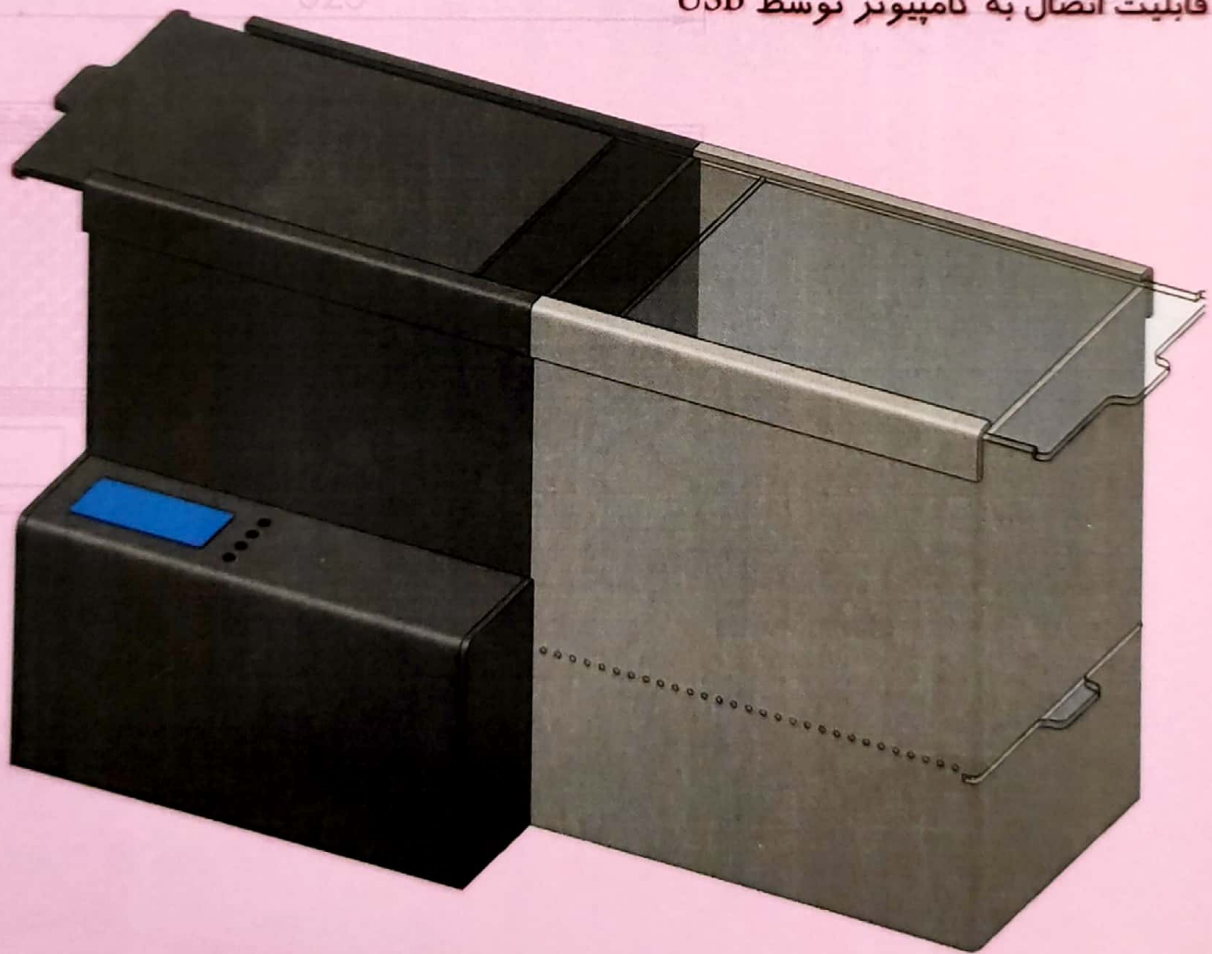

شرکت نوآوران صنایع آموزشی  
با همکاری گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تلفن:  
مهندس محسن سعید جلالی 09153145665  
مهندس محمدرضا طهانی 09153149118